



## **VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY**

**Generální ředitelství, odbor zdravotnické služby**

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

NAŠE č. j.: VS 88/001/010/2015-50/ZDR/812

VYŘIZUJE: Mgr. Michal Barák

TELEFON: 244 024 910

E-MAIL: [mbarak@grvs.justice.cz](mailto:mbarak@grvs.justice.cz)

V Praze dne 3. 9. 2015

### **Dodatečné informace - změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Veřejná zakázka malého rozsahu

**„GŘ OZS – dodávka screeningových testovacích panelů“  
(dále jen „veřejná zakázka“)**

Zadavatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky  
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, jejímž jménem je  
oprávněn činit právní úkony  
Ing. Milan Bartoloměj, MSc, LL.M, DBA, PhD., ředitel odboru  
zdravotnické služby

(dále jen „zadavatel“)

Způsob zadání: Zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o  
veřejných zakázkách

## I. Změna technické specifikace

Zadavatel tímto opravuje a mění článek II. odst. 2 zadávací dokumentace. Znění předmětného ustanovení se nahrazuje zněním:

### „2. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Screeningové testovací panely ke stanovení metabolitů drog ve slinách.

Testy mají formu multipanelů a stanovují metabolity následujících druhů drog:

- metamfetaminy (detekční limit 500 ng/ml slin)
- opiáty (detekční limit 300 ng/ml v slin)
- THC (detekční limit 50 ng/ml slin)
- benzodiazepiny (detekční limit 300 ng/ml slin)
- buprenorfin (detekční limit 10 ng/ml slin)

Detekční limit je stanoven jako maximální, tj. minimální požadovaná citlivost testu. Zadavatel bude akceptovat i testy s vyšší citlivostí.

Zadavatel dále požaduje

Maximální doba odečtu činí 10 minut

expirační doba činí nejméně 16 měsíců ode dne dodání zboží

součástí každé dodávané šarže bude odpovídající šaržový certifikát

součástí každé dodávky bude návod na použití v českém jazyce včetně uvedení specifik a možných interferencí

součástí každé dodávky bude prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 453/2004 Sb., k provedení zákona č. 123/2000 Sb.

uchazeč v technické dokumentaci zboží uvede obchodní název testů a jméno výrobce

Kód NIPEZ

33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál“

Změna technické specifikace se týká opravy administrativní chyby, když na místo slova „slin“ byl v textu uveden text „moči“. Současně zadavatel zrušil požadavek, aby testovacími panely bylo možné provádět test ředění moči.

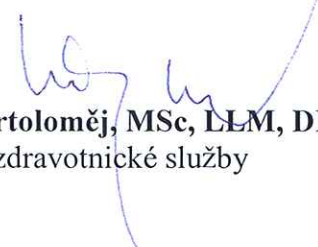
Zbýlý text měněného ustanovení včetně detekčních limitů zůstává beze změny.

## II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na doplňující informace, které zadavatel zveřejnil na portálu zadavatele EZAK na základě dotazů uchazečů, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Termín pro podání nabídek: 11. 9. 2015 10:00

V Praze dne 3. 9. 2015

  
**Ing. Milan Bartoloměj, MSc, LL.M, DBA, PhD.**  
ředitel odboru zdravotnické služby